

让校准测试更智慧



声明

本说明书中产品技术指标及配件等相关信息仅供参考，最终以用户实际订单为准，请订货时确认。产品发展有时会涉及技术指标及配件等更改，恕不另行通知。

ConST 101-2

自动回零器使用说明书

[版本号：2509V04]

北京康斯特仪表科技股份有限公司

网址：www.constgroup.com

电话：010-56973333




下载更多资料



基本结构

压力范围：(0~100) MPa


工作介质：无腐蚀性液体

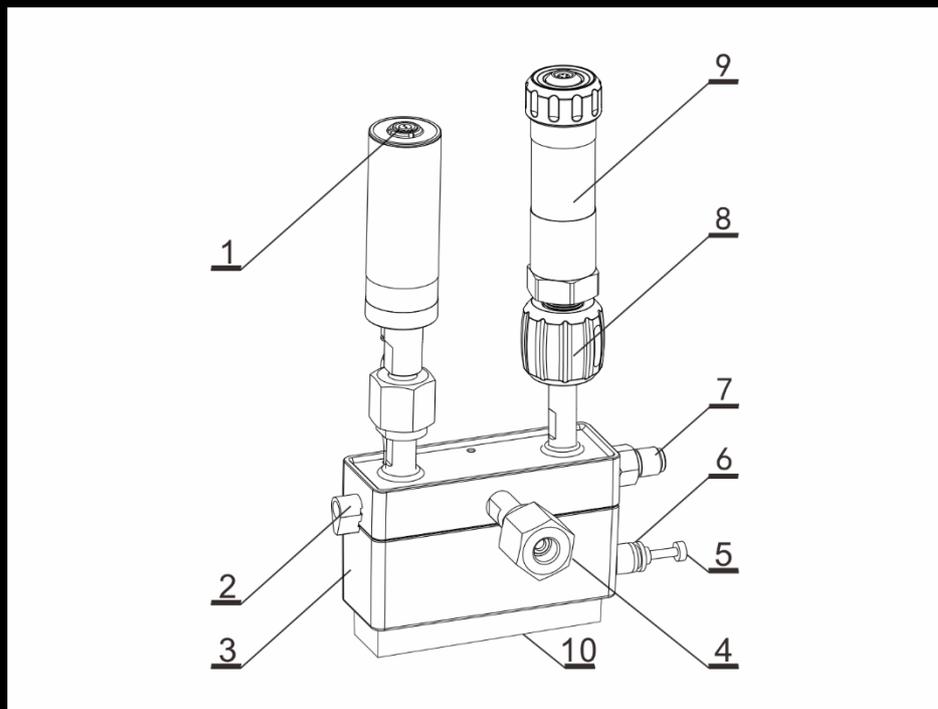

序号	名称	说明
1	航插接口	排空阀控制航插与压力控制器连接
2	储油箱压扣	储油箱限位锁扣
3	储液盒	容量 150ml
4	压力输出接口	G1/4 标准内螺纹
5	堵头	快插接头堵头
6	放油接头	可插接 $\phi 8$ 的软管, 外接储油桶
7	压力输入接口	G1/4 标准外螺纹
8	快接头组件	被检压力接口, 标配 M20X1.5, 可根据需要选配
9	模块式压力校验仪	此设备需另购
10	垫块	与 ConST801 配合使用时需要安装

典型连接

与 ConST860/870 智能压力控制器（液压版）的连接。

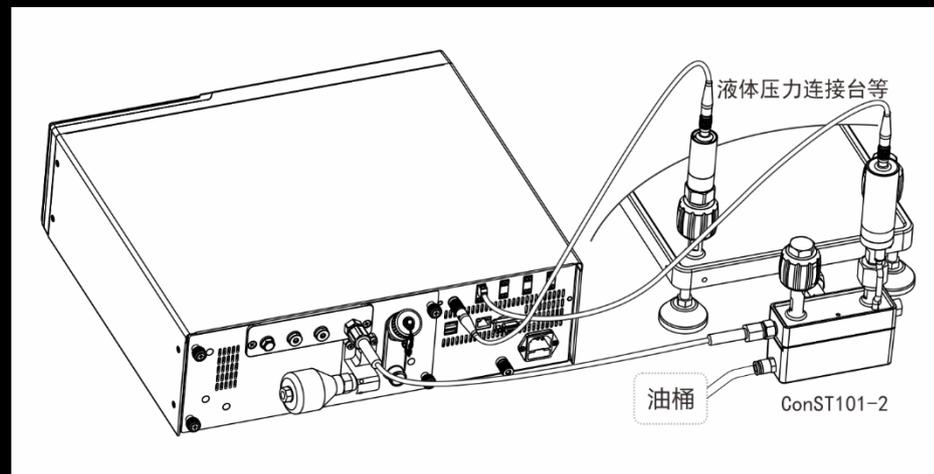

注：示意图中液体压力连接台、配附件以用户实际订单为准。